



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO: CAC001-16 VERSIÓN: 01 CÓDIGO: IEPR- CAC001-16

SUSTITUYE A:	VIGENCIA:	PROXIMA REVISIÓN:
Nuevo ELABORÓ: 	3 años REVISÓ: 	MAY 2028 AUTORIZÓ:
Carina Jiménez feria Producción FECHA: 30 - MAY - 2025	I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 30 - MAY - 2025	I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 30 - MAY - 2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Plato ovalado	1
2	Apósito transparente 10X12 cm	1
3	Toallas con alcohol isopropílico al 70%	5
4	Gasas 7.5x5 cm	2
5	Aplicador de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%	1
6	Guante mediano acondicionado	2
7	Envoltura plana 40g 50x50 cm	1
8	Cubre boca de alta filtración con resorte	1

Observaciones: Descripciones específicas en la OP

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble		
Descripción	Parámetros de uso	
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.	
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.	

Innplast
COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:

CAC001-16

VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IEPR- CAC001-16

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 plato ovalado.	2	Colocar 1 apósito transparente 10X12 cm
			
			
Criterio:	Se coloca horizontalmente sobre la mesa.	Criterio:	Se coloca sobre el plato.

inoplast  

3	Colocar 5 toallas con alcohol isopropílico	4	Colocar 2 gasas de 7.5X5 cm.
			
			
Criterio:	Se colocan 5 toallas con alcohol isopropílico sobre el apósito de lado izquierdo	Criterio:	Se colocan 2 gasas del lado derecho con la costilla hacia en frente.

COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:


CAC001-16

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CAC001-16

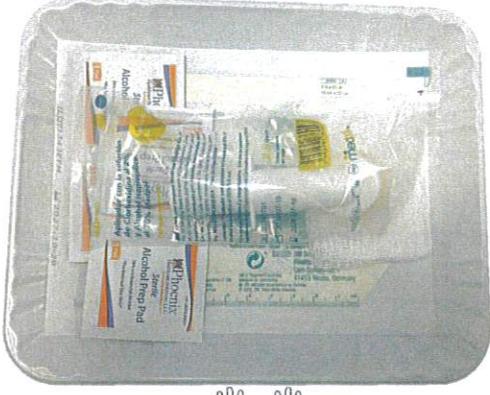5	Colocar 1 aplicador de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% de 3 mL.	6	Colocar 2 guantes medianos.
			
Criterio:	Se coloca centrado 1 aplicador de clorhexidina.	Criterio:	Se colocan un par de guantes con los dedos en dirección a la izquierda.

7	Envoltura plana 40 50x50 cm	8	Se acomoda el equipo a envolver sobre la envoltura
			
Criterio:	Colocar una envoltura sobre la mesa.	Criterio:	Se coloca el kit sobre la envoltura.

PRODUCTO:

KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:

CAC001-16





VERSIÓN:

01

CÓDIGO:





IEPR- CAC001-16

- 9 Doblar la punta inferior (B) de la envoltura hacia arriba y dar un pequeño doble hacia dentro y jalar la punta (A) hacia arriba.




Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.

- 10 Se coloca un cubre boca sobre el kit. En el punto C se deberá doblar el costado para después subir la pestaña hacia el centro.



Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.

- 11 En el punto D se deberá doblar el costado para después subir la pestaña hacia el centro de manera que las pestañas C y D al reunirse en el centro se realice un triángulo en la punta A.

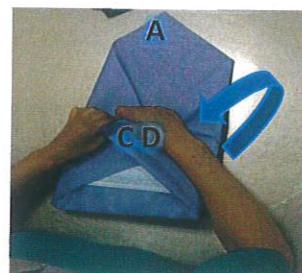

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.



Innplast

impresión

COPIA CONTROLADA

PRODUCTO:
KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:

CAC001-16



VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CAC001-16

- 12 Girar 180 ° el equipo ensamblado, bajar la punta A para dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular (referencia).

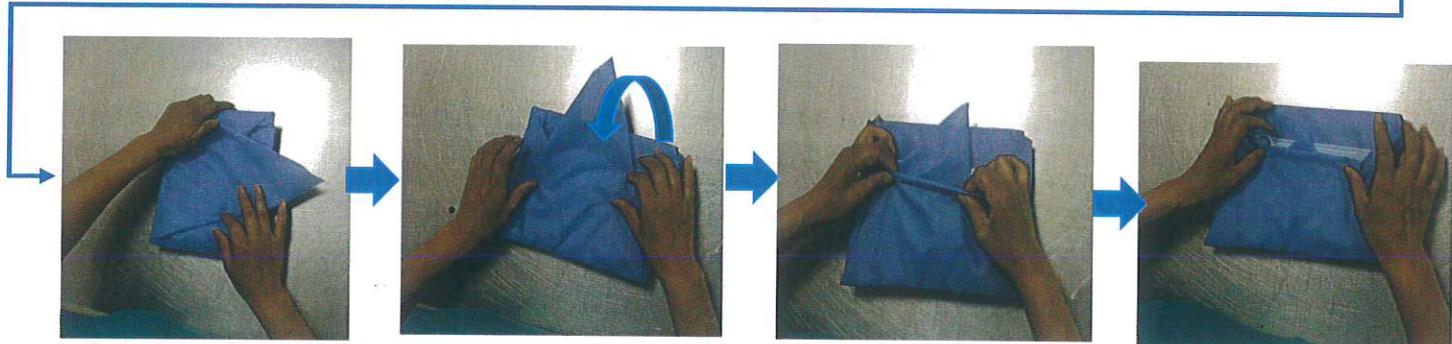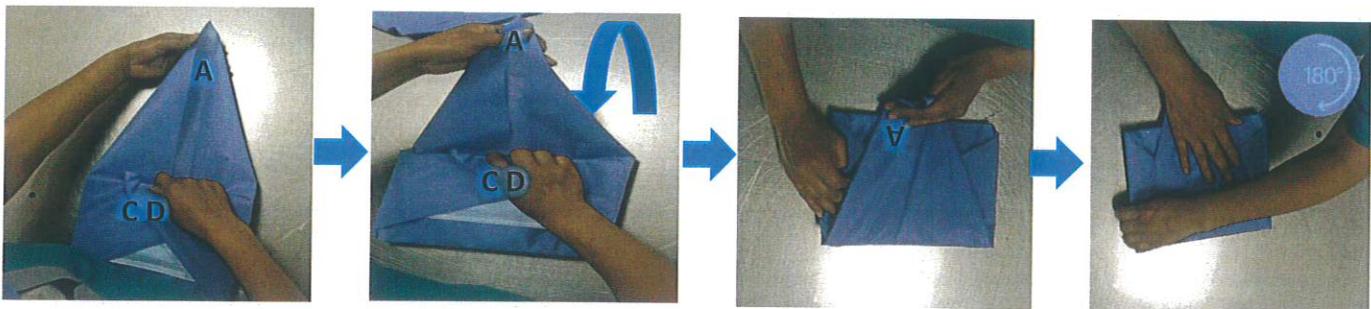

- Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva, para así obtener de resultado el kit ya terminado.

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento (usar tapa si estos quedaran retenidos para su acondicionamiento subsecuente).



COPIA CONTROLADA

No. _____


HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:
KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:	CAC001-16	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CAC001-16
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

SUSTITUYE A:	VIGENCIA:	PROXIMA REVISIÓN:
NUEVO  Carina Jiménez Feria producción FECHA: 30-MAY-2025	3 años  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 30-MAY-2025	KIAK-2028  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 30-MAY-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja cartón doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		


innplast medico
COPIA CONTROLADA

No. 1

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (Aplica cuando el cliente lo solicite)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación
Tijeras (Para el refile de bolsa cuando aplique o para cortar cinta indicadora de esterilización)	Limpias y libre de contaminación

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpios y libres de contaminación
Máquina precintadora	29 cm de alto x 28.5 cm de ancho para el sellado

PRODUCTO:

KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:

CAC001-16

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-CAC001-16

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (Bolsa)	2	Introducir el producto dentro del empaque primario
			
Criterio:	No debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar al centro de manera horizontal o vertical. Colocar la cinta testigo de viraje en el recuadro de la etiqueta (cuando aplique)	Criterio:	Como se muestra en la imagen
3	Sellar la el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora	4	Almacenar en los contenedores
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Cuando aplique para manipulación y transporte

PRODUCTO:
KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:

CAC001-16

VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-CAC001-16

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen	2	Sellar la caja con la maquina precintadora
			
Criterio:	Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque	Criterio:	Como se muestra en la imagen

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "Restos-Caja Parcial" en la esquina superior derecha Colocar el sello en la parte inferior derecha del empaque secundario, indicando los últimos tres dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realiza el acondicionado
---	--

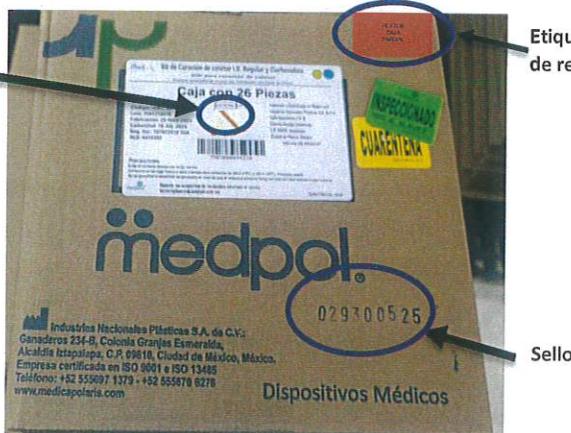		<p>Formato del sello</p> <pre> COD DD MM AA ↓ ↓ ↓ ↓ COD: Código de la máquina. DD: DIA Los 2 dígitos del día. MM: MES Los 2 dígitos del mes. AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año. ↓ ↓ ↓ ↓ 029040425 </pre> <p>EJEMPLO</p>
Criterio:	La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen La caja no debe estar rota, sucia o manchada	





INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

KIT DE CURACIÓN CATÉTER I.V. REGULAR Y CLORHEXIDINA

CATÁLOGO:	CAC001-16	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CAC001-16
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas



Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100x120 CM

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento (usar tapa si estos quedaran retenidos para su acondicionamiento subsecuente).

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

Innplast
COPIA CONTROLADA

No. 1