



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO: NUA001-33 VERSIÓN: 01 CÓDIGO: IEPR-NUA001-33

| SUSTITUYE A: | VIGENCIA: | PROXIMA REVISIÓN: |
|--|---|--|
| NUEVO | 3 años | AGO-2028 |
| ELABORÓ: Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 01-AGO-2025 | REVISÓ: I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 01-AGO-2025 | AUTORIZÓ: I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 01-AGO-2025 |

1. INSUMOS REQUERIDOS:

| Ensamble | | |
|----------|----------------------------|----------|
| Ítem | Insumo | Cantidad |
| 1 | Riñón graduado de 500 ml | 1 |
| 2 | Recipientes de 59 ml (2oz) | 2 |
| 3 | Gasas de 5x5 cm | 2 |
| 4 | Envoltura línea 50x50cm | 1 |

Observaciones: Descripciones específicas en la OP

2. EQUIPO A UTILIZAR:

| Ensamble | Descripción | Parámetros de uso |
|--|-------------|--|
| Mesa de acero inoxidable | | Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas. |
| Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique) | | Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón. |

innplast
COPIA CONTROLADA
No. 1



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33

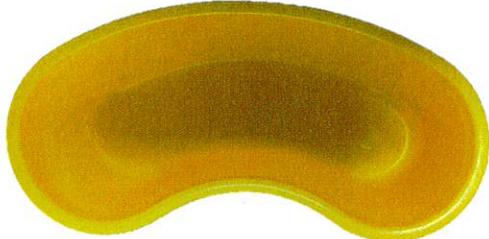

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-NUA001-33

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| 1 | Colocar un riñón graduado de 500 ml | 2 | Colocar 2 Gasas de 5x5 cm |
|  |  | | |
| Criterio: | Se coloca horizontalmente | Criterio: | Como se muestra en la imagen |
| 3 | Colocar 2 recipientes de 59 ml (2oz) | 4 | Sobre la mesa de trabajo se coloca la envoltura línea 50x50cm |
|  |  | | |
| Criterio: | Como se muestra en la imagen | Criterio: | La envoltura se coloca en forma de rombo. |

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-NUA001-33

| | |
|--|--|
| | 5 Se acomoda el equipo a envolver sobre la envoltura |
|--|--|



| | |
|--|--|
| | Criterio: Acomodar el equipo ensamblado como se muestra en el paso 3 |
|--|--|

| | | |
|--|--|-------------------------|
| | 6 Envolver. Doblar la punta inferior (Punto A) de la envoltura hacia arriba y doblar hacia abajo del riñón | COPIA CONTROLADA |
|--|--|-------------------------|

No. _____



| | |
|--|---|
| | Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado |
|--|---|

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-NUA001-33

- 7 Del punto C realizar un pequeño doblez hacia dentro para formar una pestaña. Pasando por arriba del kit manteniéndolo sujeto



Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado

- 8 Del punto E realizar un pequeño doblez hacia dentro, para formar una pestaña, Pasar por arriba del kit juntando la punta E y C



Criterio: Apretar el equipo con la envoltura.


COPIA CONTROLADA
No. 1

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-NUA001-33

- 9 Juntar y dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y E para formar la pestaña triangular.



- Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

- 10 Girar 180 ° el equipo ensamblado



- Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

| | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----|---------|----------------|
| CATÁLOGO: | NUA001-33 | VERSIÓN: | 01 | CÓDIGO: | IEPR-NUA001-33 |
|-----------|-----------|----------|----|---------|----------------|

- 11 Tomar la punta de la pestaña (punto H) y doblar hacia la parte inferior.



Criterio: Como se muestra en la imagen

- 12 Resultado final del ensamble.



Criterio: No debe quedar flojo

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

| HISTORICO DE CAMBIOS | VERSIÓN | NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS |
|----------------------|---------|------------------------------|
| | 01 | N/A |



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

| | | | | | |
|--|---|--|----|-------------------|----------------|
| CATÁLOGO: | NUA001-33 | VERSIÓN: | 01 | CÓDIGO: | IAPS-NUA001-33 |
| SUSTITUYE A: | | VIGENCIA: | | PROXIMA REVISIÓN: | |
| Nuevo | | 3 años | | AGO-2028 | |
| ELABORÓ: Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 01-AGO-2025 | REVISÓ: I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 01-AGO-2025 | AUTORIZÓ: I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 01-AGO-2025 | | | |

1. INSUMOS REQUERIDOS:

| Acondicionamiento Primario | | |
|---|---|----------|
| Ítem | Insumo | Cantidad |
| 1 | Bolsa mixta para esterilizar | 1 |
| 2 | Etiqueta primaria | 1 |
| 3 | Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente) | 1 |
| Acondicionamiento Secundario | | |
| 1 | Caja cartón doble corrugado 54x29x28 | 1 |
| 2 | Etiqueta secundaria | 1 |
| 3 | Cinta indicadora de esterilización | 1 |
| Observaciones: Descripciones específicas en la OP | | |

2. EQUIPO A UTILIZAR:

| Acondicionamiento Primario | |
|--|---|
| Descripción | Parámetros de uso |
| Selladora de banda | 180°C a 200°C |
| Mesa de acero inoxidable | Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas. |
| Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique) | Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón. |
| Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique) | 20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación. |
| Tijeras (para el refile de bolsa cuando aplique o para cortar la cinta indicadora de esterilización) | Limpias y libre de contaminación |

| Acondicionamiento Secundario | |
|--|---|
| Descripción | Parámetros de uso |
| Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras) | 20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación. |
| Máquina precintadora | 30 cm de ancho x 29 cm de alto |





INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-NUA001-33

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 1 | Etiquetar el empaque primario (bolsa) | 2 | Introducir el producto dentro del empaque primario |
| | | | |
| Criterio: | Al colocar la etiqueta no debe presentar algún daño físico que afecte su legibilidad. Nota: solo se coloca la cinta testigo en la etiqueta cuando sea requerida. | Criterio: | Como se muestra en la imagen |
| 3 | Sellar el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora | 4 | Almacenar en los contenedores |
| | | | |
| Criterio: | No debe tener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto. | Criterio: | Cuando aplique para manipulación y transporte |

PRODUCTO:
NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-NUA001-33

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:


| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Empacar como se muestra en la imagen | 2 | Sellar la caja con la maquina precintadora |
|  | | |  |

Criterio: Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque

Criterio: Como se muestra en la imagen

 
Innplast **medpol**
COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|--------------|
| 3 | Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "Restos-caja parcial" en esquina superior derecha Colocar el sello en la parte inferior derecha del empaque secundario. | No. <u>1</u> |
|---|---|--------------|

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Identificación de etiqueta caja parcial</p> | | FORMATO DEL SELLO  <p>EJEMPLO</p> |
| <p>Criterio: La etiqueta debe estar libre de cualquier tipo de daño físico (arrugas, pliegues, cortes) que afecte su legibilidad. La caja no debe estar rota, sucia o con alguna imperfección que dañe el empaque primario. El sello indica los últimos tres dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en la que se realizó el acontecimiento.</p> | | |




INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:


NUTRICION DE BEBÉ

| | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----|---------|----------------|
| CATÁLOGO: | NUA001-33 | VERSIÓN: | 01 | CÓDIGO: | IAPS-NUA001-33 |
|-----------|-----------|----------|----|---------|----------------|

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas



Cama 1



Cama 2

| | |
|-----------|-----------------------|
| Criterio: | ESTIBA: T-100cmx120cm |
|-----------|-----------------------|

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.
No se exponga a la humedad mayor a 65%.
Empaque primario frágil manipular con cuidado.
Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

| HISTORICO DE CAMBIOS | VERSIÓN | NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS |
|----------------------|---------|------------------------------|
| | 01 | N/A |

