

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:	CDC301-27	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR-CDC301-27
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

SUSTITUYE A:	VIGENCIA:	PROXIMA REVISIÓN:
--------------	-----------	-------------------

Nueva

3 años

ENE - 2029

ELABORÓ:



Carolina Hernández Hernández
Producción
FECHA: 05 - ENE - 2026

REVISÓ:



IQI. Sergio Bautista Sampedro
Coordinador de Producción
FECHA: 06 - ENE - 2026

AUTORIZÓ:



QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva
Responsable Sanitario
FECHA: 07 - ENE - 2026

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Conexión de catéter estéril adulto I		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Campo plano de 35g-45g 30 x 40 cm	1
2	Guantes para exploración medianos	2
3	Gasas 7.5 x 5 cm	10
4	Jeringa desechable sin aguja de 5 ml	1
5	Jeringa desechable sin aguja de 10 ml	1
6	Guantes para exploración medianos	2
Desconexión de catéter estéril adulto I		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Apósito absorbente de 10 x 15 cm	1
2	Gasa 10 x 10 cm	1
3	Tapones luer lock	2
4	Gasas 7.5 x 5 cm	5
5	Guantes para exploración medianos	2
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	Descripción	Parámetros de uso
	Mesa de acero inoxidable.	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
	Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique).	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27

VERSIÓN:


01

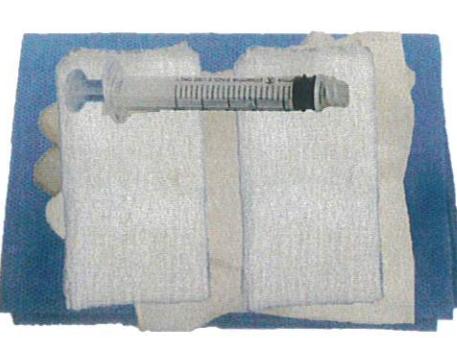
CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE: CONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

1	Colocar en la mesa de trabajo 1 campo plano de 35g-45g 30 x 40 cm.	2	Colocar 2 guantes para exploración medianos.
---	--------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------

	
<p>Criterio: Se coloca de manera que la costilla quede hacia la parte superior.</p>	<p>Criterio: Se colocan encima del campo plano de 35g-45g 30 x 40 cm de manera que los dedos apunten al lado izquierdo.</p>

3	Colocar 10 gasas 7.5 x 5 cm.	4	Colocar 1 jeringa desechable sin aguja de 5 ml.
			

<p>Criterio:</p>	<p>Se colocan encima de los guantes para exploración medianos dividido en dos partes de manera vertical.</p>	<p>Criterio:</p>	<p>Se coloca encima de las gasas 7.5 x 5 cm de manera horizontal.</p>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:


CDC301-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

5	Colocar 1 jeringa desechable sin aguja de 10 ml.	6	Colocar 2 guantes para exploración medianos.
	 	 	VISTA FRONTAL 

7	Producto terminado de ensamblar.
	VISTA FRONTAL  

Criterio: Quedando como se muestra en la imagen al termino del ensamble.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27


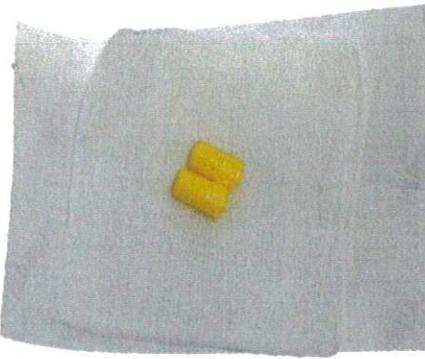

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE: DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

8	Colocar en la mesa de trabajo 1 apósito absorbente de 10 x 15 cm.	9	Colocar 1 gasa 10 x 10 cm.
			
			
Criterio:	Se coloca de manera horizontal.	Criterio:	Se coloca encima del apósito absorbente de 10 x 15 cm.
10	Colocar en la mesa de trabajo 2 tapones luer lock.	11	Colocar 5 gasas 7.5 x 5 cm.
			
			
Criterio:	Se colocan encima de la gasa 10 x 10 cm.	Criterio:	Se colocan encima de los tapones luer lock de manera vertical.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

12	Colocar 2 guantes para exploración medianos.	13	Producto final.
		 <p>VISTA FRONTAL</p>	
Criterio:	Por último se colocan los guantes quedando encima de las gasas 7.5 x 5 cm de manera que los dedos apunten al lado izquierdo.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

14	Producto terminado de ensamblar.
 <p>VISTA FRONTAL</p>	
Criterio:	Quedando como se muestra en la imagen al termino del ensamble.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:**KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I**

CATÁLOGO:

CDC301-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

15 El kit no lleva proceso de envoltura.

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

No mayor a la fecha de caducidad para evitar la proliferación de algún tipo de microbios o bacterias.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:	CDC301-27	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CDC301-27
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
NUEVO		3 años		ENE - 2029	
ELABORÓ:		REVISÓ:		AUTORIZÓ:	
Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 05-ENE-2026		IQI. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 06-ENE-2026		QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva Responsable Sanitario FECHA: 07-ENE-2026	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	2
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	30 cm de ancho x 29 cm de altura

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:	CDC301-27	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CDC301-27
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			 Primer embolsado  Segundo embolsado
Criterio:	<p>La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad como arrugas, pliegues o cortaduras se coloca de forma horizontal.</p> <p>Verificar que contenga la cinta indicadora de esterilización.</p>	Criterio:	<p>Se introduce el kit como se muestra en la imagen sin soltar ningún insumo.</p>
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en los contenedores.
	 		
Criterio:	<p>No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.</p>	Criterio:	<p>Para la manipulación y transporte.</p>

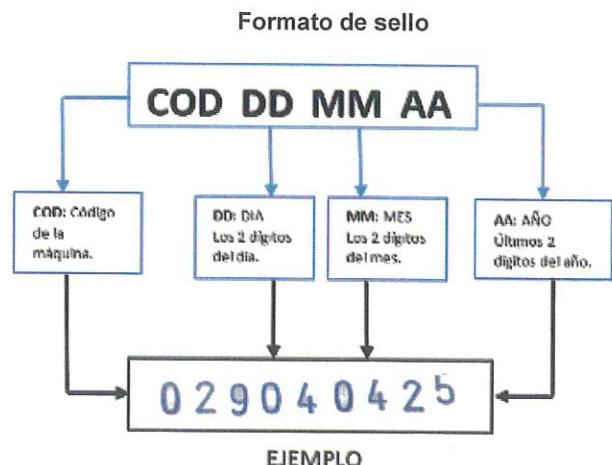
PRODUCTO:
KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO: CDC301-27 VERSIÓN: 01 CÓDIGO: IAPS-CDC301-27

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Doblar a la mitad colocándolos de frente vs frente cada producto, hacer pares de lados contrarios y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.



3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
Criterio:	Formato de sello  El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionado. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:	CDC301-27	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CDC301-27
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

4	Estivar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas.
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Cama 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cama 2</p> </div> </div>
Criterio:	ESTIBA: T-100 cm x120 cm

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.
 No se exponga a la humedad mayor a 65%.
 Empaque primario frágil manipular con cuidado.
 Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A